



T.C.
GAZİANTEP VALİLİĞİ
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü
Şehitkamil Devlet Hastanesi

30.01.2023

Sayı: 48736255 /
Konu: Fiyat Teklifi

İNTERNETTE YAYINLANMASI

Hastanemizin ihtiyacı olan STERİLİZASYON YEDEK PARÇA ALIMI işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22/d usulü ile satın-alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V.hariç fiyat teklifi göndermenizi, müdürlüğümüz satın alma birimine veya mail adresine bildirilmesi hususunu;

Bilgilerinize rica ederim.


Mehmet Nizamettin YILDIZ
Müdür Yardımcısı

Son Teklif Verme Tarihi:03.02.2023 10:00

Teklif Başvuru Yeri	ŞEHİT KAMİL DEVLET HASTANESİ SATIN ALMA BİRİMİ
Teslimat Yeri	ŞEHİT KAMİL DEVLET HASTANESİ
Teklif Türü	Teklif Birim Fiyat-İş Kalemleri Bazında

Dikkat Edilecek Hususlar ve Alım Şartları

TEKLİF CETVELİ

S.No	Malzeme Adı	Birimi	Miktar	Birim Fiyatı	ToplamTutar
1	BUHAR OTOKLAVI KAYAR İÇ KAPAK CONTASI - SLİKONLU VE DAİRESEL	Adet	8		
2	OTOKLAV SOLENOİD VALFİ	Adet	4		
3	OTOKLAV ACİL-STOP BUTONU	Adet	4		
4	OTOKLAV CİHAZI HEPA FİLTRESİ	Adet	3		
5	YIKAMA / DEZENFEKSİYON CİHAZI KAPI KİLİDİ	Adet	2		
6	YIKAMA / DEZENFEKSİYON CİHAZI ISITICI DİRENÇ / REZİSTANSI	Adet	2		
7	OTOKLAV CİHAZI PLC ANALOG MODÜLÜ	Adet	1		
8	80 AMPER W OTOMAT	Adet	6		
Genel Toplam:					

T.C

SAĞLIK BAKANLIĞI

ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ

**BUHAR OTOKLAVI KAYAR İÇ KAPAK CONTASI-SİLİKONLU VE
DAİRESEL TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. 180 derece sıcaklığa kadar dayanıklı olmalıdır.
2. Silikon ve dairesel olmalıdır.
3. Erna marka 6610 modeli olan otoklav buhar cihazına uyumlu olmalıdır.
4. Parça denenerek uygunluk verilecektir.


Vedat Kara



Muzafer Orhan



Recep GÜNEŞ
Biyomedikal Tekniker

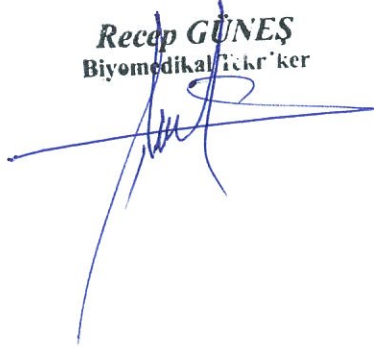

T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ

OTOKLAV SELENOİT VALFİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1 / 2 dişli dişli olmalıdır
- Genel maksatlı olmalıdır
- 220 volt bobinli olmalıdır
- Erna marka 6610 modeli olan otoklav buhar cihazına uyumlu olmalıdır
- Parça denenerek uygunluk verilecektir


Vedat Kara



Muzafer Orhan



Recep GÜNEŞ
Biyomedikal Tekniker

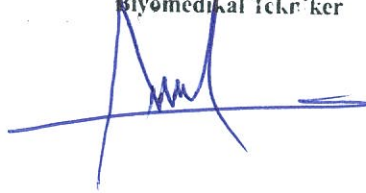

T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ

OTOKLAV CİHAZI ACİL STOP BUTONU ŞARTNAMESİ

- Acil stop butonu EN ISO 13850 standardına uygun olmalıdır.
- Erna marka 6610 modeli otoklav buhar cihazına uyumlu olmalıdır.
- Kontak akımı 4 A 250V AC olmalıdır.
- Kırmızı renkli, kilitli ve çevirmeli tip olmalıdır.
- Çalışma sıcaklığı -15/+120 derece olmalıdır.
- IP50 koruma sınıfı olmalıdır.
- 1 adet NO ve 1 adet NC kontaklı olmalıdır.
- Parça denenerek uygunluk verilecektir.

Vedat Kara



Recep GÜNEŞ
Biyomedikal Tekniker



Murat Örtken



T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ


OTOKLAV CİHAZI HAVA FİLTRESİ ŞARTNAMESİ

- 1/2 inç dişi dişli olmalıdır.
- Silindir tipli olmalı ve kolay montaj edilmelidir.
- Montajda ek herhangi bir aparata ihtiyaç duyulmamalıdır.
- Geçirgenliği 0,99 hepa özellikli olmalıdır.
- Erna marka 6610 modeli otoklav buhar cihazına uyumlu olmalıdır.
- Parça denenerek uygunluk verilecektir.

Nedat Karam



Recep GÜNEŞ
Biyomedikal Tekniker

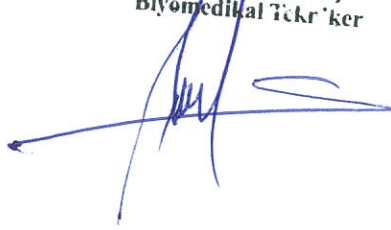

Muzaffer Orhan



T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ

YIKAMA VE TERMAL DEZENFEKSİYON CİHAZI KAPI EMNİYET KİLİDİ

- FRANKE DEKO 2000-2K cihaza uyumlu olmalıdır.
- 220 V elektrik ile beslenmesi olmalıdır.
- Parça denenerek uygunluk verilecektir.

Yedat Kara



Recep GÜNEŞ
Biyomedikal Tekniker



Muzafer Orhan



T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ

YIKAMA VE TERMAL DEZENFEKSİYON CİHAZI KURUTMA REZİSTANSI

- FRANKE DEKO 2000-2K cihaza uyumlu olmalıdır.
- 750 W VE 1630 W iki kademeli olup 220 V elektrik ile beslenmesi olmalıdır.
- Parça denenerek uygunluk verilecektir.

Veçhâ Kona



Muzafer Orhan




Recep GÜNEŞ
Biyomedikal Tekniker



PT100 MODÜLÜ ŞARTNAMESİ

1. EM231 Serisi AI2xRTD model olacaktır.
2. İki analog girişı olan PT100 modülü olacaktır.
3. 24 volt DC besleme girişı olacaktır.
4. Erna marka 6610 modeli olan otoklav buhar cihazının orijinal parçası olmalıdır.

Vedat Kara

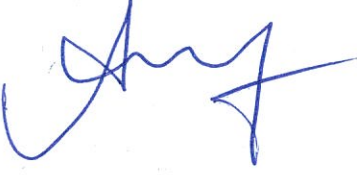


Muzaffer Orhan



T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ

OTOKLAV CİHAZI 80 A W OTOMAT ŞARTNAMESİ

- 1x80 A 10 Ka olmalıdır.
- Ray tipi olmalı ve kolaylıkla montaj edilmelidir.
- Ürün TSE belgesine sahip olmalıdır
- Erna marka 6610 modeli otoklav buhar cihazına uyumlu olmalıdır.
- Parça denenerek uygunluk verilecektir.

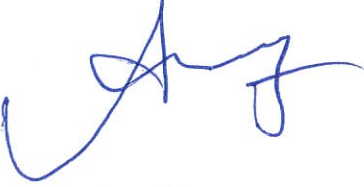Yedat Kara


Musaffer Orhan
